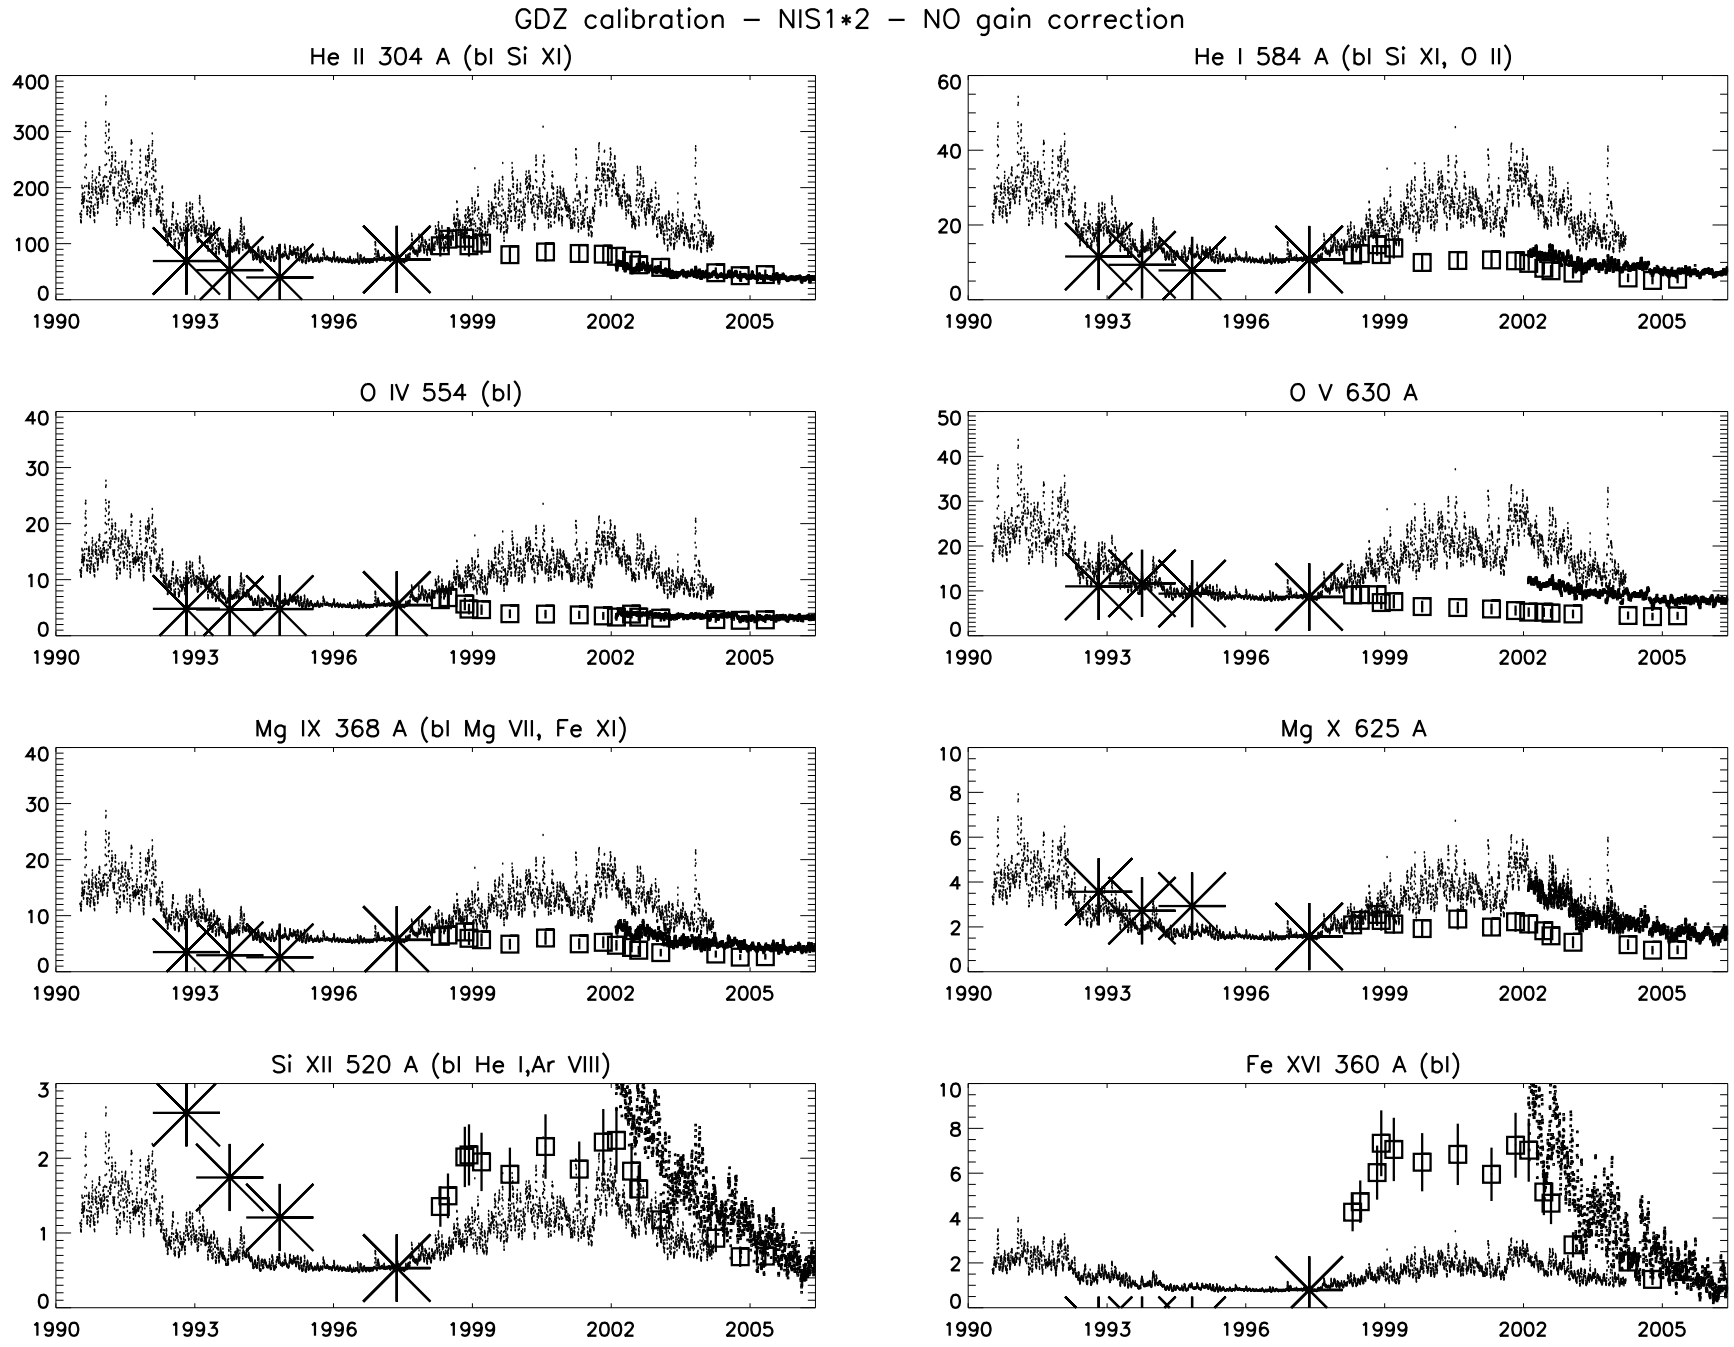
GDZ calibration – NIS1*2 – NO gain correction
He II 304 A (bl Si XI)
He I 584 A (bl Si XI, O II)
O IV 554 (bl)
O V 630 A
Mg IX 368 A (bl Mg VII, Fe XI)
Mg X 625 A
Si XII 520 A (bl He I,Ar VIII)
Fe XVI 360 A (bl)
1990
1993
1996
1999
2002
2005